Para el uso exclusivo de Médicos Registrados, Hospitales y Laboratorios

Auto-Prueba de VIH Mylan

es el primer dispositivo integrado de Auto-Prueba de VIH.[1]

Precalificado por la OMS[2]

Segura[1]

Conveniente[1]

Exacta[1]

- ☑ Elimina la necesidad de componentes de prueba múltiples[1]
- ☑ Simplifica los procedimientos de prueba[1]
- ☑ Reduce los errores del usuario[1]
- ☑ Mejora la exactitud de la prueba[1]

OMS: Organización Mundial de la Salud

Mylan

Better Health for a Better World

Auto-Prueba de VIH de Mylan es Fácil de Utilizar

Paso 1

Presione el botón gris para **pinchar el dedo con la Lanceta integrada.**[1]

Paso 2

Llene el tubo con sangre. Si el tubo no está lleno, **apriete** el dedo y agregue más sangre.[1]

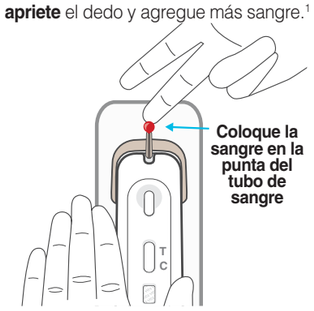

Paso 3

Sostenga la prueba en la mesa.**Voltee el tubo hacia** la cavidad.[1]

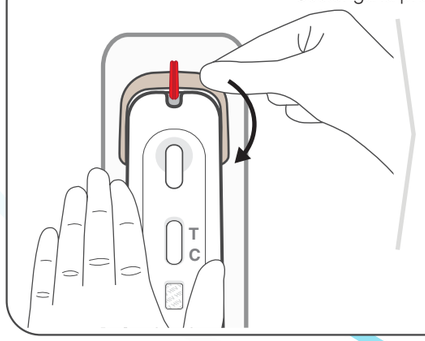

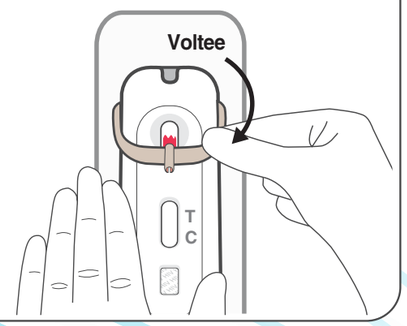

Paso 4

Agregue **4 gotas del fluido de prueba** en la cavidad.[1]

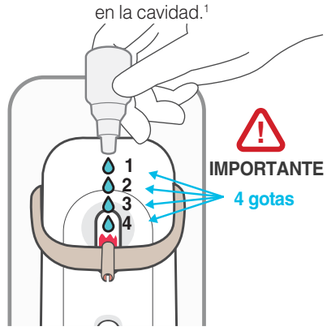

Paso 5

Espere **15 minutos** antes de leer el resultado. No espere más de 20 minutos.[1].

VIH negativo

Si aparece una línea en la C, su prueba para VIH es negativa. No debe haber ninguna línea en la T.

Esta es una prueba de detección. Pruebe nuevamente después de 3 meses.

Vea la tarjeta de cuidado incluida para información adicional.

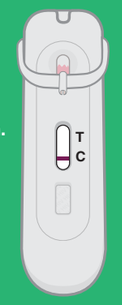

La prueba no funcionó

Si no aparece ninguna línea en la C, la prueba no funcionó.

Esta es una prueba de detección. Visite una clínica para pruebas adicionales.

Vea la tarjeta de cuidado incluida para información adicional.

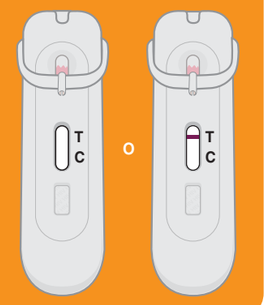

VIH positivo

Si aparecen dos líneas, aunque sean débiles, su prueba para VIH es positiva.

Esta es una prueba de detección. Visite una clínica para pruebas adicionales.

Vea la tarjeta de cuidado incluida para información adicional.

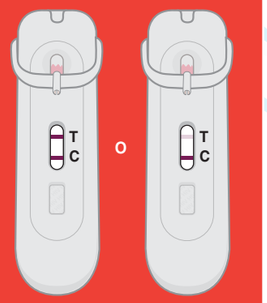

Para más información y para ver el video del procedimiento paso a paso, visite: https://www.mylanez2uz.com

Nota Importante: Lave y seque sus manos antes de realizar la prueba. Las instrucciones para el uso incluidas en el empaque deben leerse cuidadosamente antes de realizar la prueba.
Esta es una prueba de detección. Si su resultado es interpretado como “VIH negativo”, realice la prueba después de 3 meses. Si el resultado es interpretado como “La prueba no funcionó” o “VIH Positivo”, visite una clínica para pruebas adicionales.

Auto-Prueba de VIH Mylan
es reconocida por su diseño innovador*

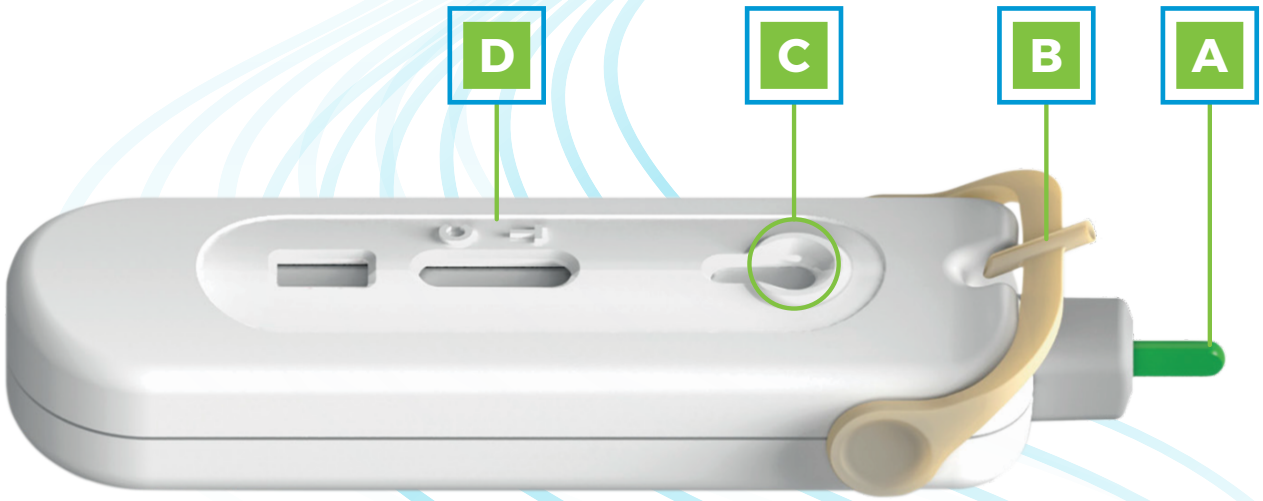

A **Lanceta de Seguridad Incorporada[1]**
La lanceta de seguridad auto-retráctil elimina el riesgo de lesiones punzantes peligrosas al bloquear la aguja adentro del dispositivo después del uso para su eliminación segura

B **Recolección de Sangre Precisa[1]**
La unidad de recolección de sangre fácil de utilizar está diseñada para recolectar exactamente el volumen correcto de muestra (10µl), asegurando el rendimiento óptimo de la prueba.

C **Fácil Entrega de Sangre[1]**
La sangre es entregada limpiamente a la tira de prueba simplemente rotando la unidad de recolecciónde sangre.

D **Fácil Interpretación de Resultados[1]**
El resultado de prueba se muestra claramente en solamente 15 minutos.

*1

GOOD DESIGN Selection

ENGINEERING EXCELLENCE AWARDS WINNER SYDNEY 2012

MEDICAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2014 BEST IN SHOW

Referencias:
1. Datos en archivo.
2. WHO PQ Public Report ; Version 1.0; July 2019.
Disponible en: https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/190708_pqdx_0320_090_00_pqpr_mylan_hiv_self_test.pdf; Accedido en 1st April 2020

Para mayor información, contacte:
Mylan Pharmaceuticals Private Limited
No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
Tel: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Oficinas Registradas
Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92,
Jubilee Hills,Hyderabad, Telangana,
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Para mayor información, visite:
www.ez2uzhivselftest.com

Síganos en:
##ez2uzhivselftest

MYL/6/2020/174/EXP/05/2022

Mylan
Better Health for a Better World